



生産／研究・開発

用途で選べる LCR メータ

LCR メータ IM3523, IM3523A, IM3533, IM3533-01 は、基本確度 ± 0.05%、広範囲の測定周波数 1 mHz (IM3523, IM3523A は 40 Hz) ~ 200 kHz、最速 2 ms の高速測定、コンタクトチェック機能による信頼性の高い測定、巻線比や相互インダクタンスの測定など、従来製品よりも高性能・高機能を実現したコストパフォーマンスの高い測定器です。生産ラインから研究開発まで、各種用途に応じて機種を選択できます。

用途に応じて選択 LCR メータ新シリーズ登場!

■ セレクション

各機種の詳細



IM3523



IM3523A



IM3533, IM3533-01

*1 用途欄中の○◎印は、ご用途への推奨状況を意味します。◎印は推奨用途です。

形名		IM3523	IM3523A	IM3533	IM3533-01
用途*1	研究・開発		○	○	◎
	トランス・コイル生産	○		◎	◎
	LCR 部品、生産	◎		◎	◎
測定項目	基本測定項目	Z (インピーダンス [Ω]) Y (アドミタンス [S]) θ (位相角 [°]) Rs (等価直列抵抗= ESR [Ω]) Rp (並列等価回路の抵抗 [Ω]) X (リアクタンス [Ω]) G (コンダクタンス [S]) B (サセプタンス [S]) Ls (直列等価回路のインダクタンス [H]) Lp (並列等価回路のインダクタンス [H]) Cs (直列等価回路の静電容量 [F]) Cp (並列等価回路の静電容量 [F]) Q (Q ファクタ (Q=1/D)) D (損失係数= tan δ)			
	Rdc (直流抵抗)	○		○ (温度補正機能付)	
	トランス測定	—		N (巻数比) M (相互インダクタンス) ΔL (インダクタンス差)	
	温度 T	—		○	
基本精度		± 0.05%rdg.			
測定周波数		40 Hz ~ 200 kHz		1 MHz ~ 200 kHz	
測定電圧		5 mV ~ 5 V		5 mV ~ 5 V/2.5 V*2	
測定時間		2 ms			
コンパレータ		2 項目について: HI/IN/LO、ABS/%/Δ%			
BIN 測定		メイン項目: 10 分類, サブ項目: 1 分類		2 項目について: 10 分類	
ケーブル長		0 m/1 m		0 m/1 m	0 m/1 m/2 m/4 m
コンタクトチェック		4 端子チェック (閾値変更) / Hi Z リジェクト			
内部 DC バイアス		—		-5 V ~ 5 V	
スイープ測定		—		—	周波数 2 ~ 801 点
ディスプレイ		モノクロ LCD		カラー TFT 5.7 inch、タッチパネル	
インターフェイス	EXT I/O, USB	○			
	USB メモリ	—		○	
	RS-232C, GP-IB, LAN	オプション (1 種類選択)	LAN のみ標準 (RS-232C, GP-IB は選択不可)	オプション (1 種類選択)	


IM3533、IM3533-01 セレクション表中の強調表示の機能は、IM3523、IM3523A と比べて優位点になります。

*2 2.5 V は低インピーダンス高精度モード時

リード部品と SMD にジャストフィット プローブ・テストフィクスチャ



指定オプションのプローブをご使用ください。指定のプローブは 1.5D-2 V の同軸ケーブルを使用しています。

リード部品用 プローブ/テストフィクスチャ

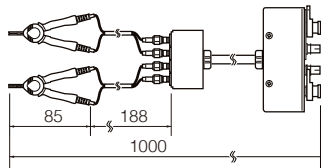


4端子プローブ L2000

ケーブル長 1 m, DC ~ 8 MHz, 特性インピーダンス 50 Ω
4端子対構造, 測定可能端子直径: 0.3 ~ 5 mm

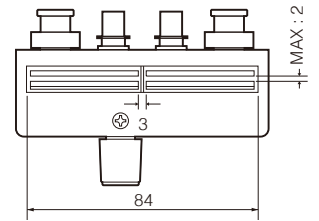




テストフィクスチャ 9262

直結型, DC ~ 8 MHz,
測定可能端子直径: 0.3 ~ 2 mm

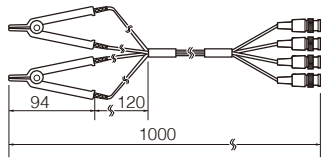

4端子プローブ 9140-10

ケーブル長 1 m, DC ~ 200 kHz, 特
性インピーダンス 50 Ω, 4端子対構
造, 測定可能端子直径: 0.3 ~ 5 mm

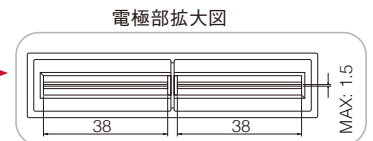

テストフィクスチャ 9261-10


ケーブル長 1 m, DC ~ 8 MHz, 特性イン
ピーダンス 50 Ω, 4端子対構造, 測定
可能端子直径: 0.3 ~ 1.5 mm

SMD用テストフィクスチャ

SMD テストフィクスチャと DUT サイズの対応表


○: 測定可能
▲: 推奨しません

SMD 種類	長さ L (mm)	幅 W (mm)	9263	9677	9699	L2001	IM9100	IM9110
0201	0.25	0.125						○
0402	0.40	0.20					○	
0603	0.60	0.30		▲		○	○	
1005	1.00	0.50		○		○	○	
1608	1.60	0.80	▲	○	○	○		
2012	2.00	1.25	○	▲	○	○		
3216	3.20	1.60	○		▲	○		
3225	3.20	2.50	○		▲	○		
4532	4.50	3.20	○			○		
5750	5.70	5.00	○			○		

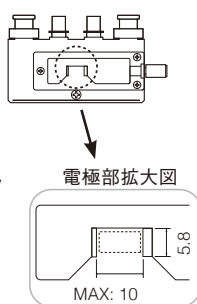


SMD テストフィクスチャ 9263

直結型, DC ~ 8 MHz,
試料寸法: 1 ~ 10 mm

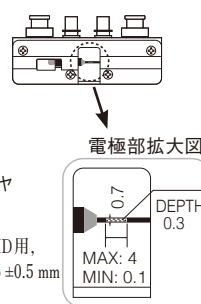

SMD テストフィクスチャ 9677

直結型, 側面に電極がある SMD 用,
DC ~ 120 MHz, 試料寸法: 3.5 ± 0.5 mm



SMD テストフィクスチャ 9699

直結型, 底面電極 SMD 用,
DC ~ 120 MHz, 試料寸法: 幅 1.0 ~ 4.0 mm, 高さ 1.5 mm 以下



SMD テストフィクスチャ IM9100

0402, 0603, 1005 サイズの SMD に対
応, DC ~ 8 MHz, 電極 4 端子構造



SMD テストフィクスチャ IM9110

0201 サイズの SMD に対応, 側面に電極が
ある SMD 用, DC ~ 1 MHz, 電極 2 端子構
造



ピンセットプローブ L2001

ケーブル長 730 mm, DC ~ 8 MHz, 特性インピーダ
ンス 50 Ω, 先端電極部 2 端子構造(電極部 - 測定
部 4 端子対構造), 先端電極間隔: 0.3 ~ 約 6 mm
IM9901 × 1 標準付属

L2001 用 オプション
ピンセット先端交換用部品



コンタクトチップ IM9901
適用チップサイズ: 1608 ~ 5750 (JIS)



コンタクトチップ IM9902
適用チップサイズ: 0603 ~ 5750 (JIS)

特長

高速・高精度で使いやすい

基本性能


IM3523, IM3523A

IM3533

IM3533-01

● 広範囲な測定周波数

DCおよび1mHz (IM3523, IM3523Aは40 Hz) ~ 200kHzの範囲内における周波数帯域を5桁分解能(100Hz未満は1mHz分解能)で設定できます。共振周波数の測定や動作条件に近い状態での測定・評価ができます。

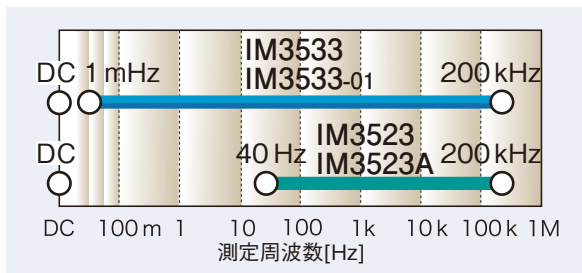

● 広範囲な測定電圧／電流

通常のオープンループの信号発生に加え、定電圧／定電流モードで電圧／電流依存性に配慮した測定が可能です。5mV ~ 5V / 10 μ A ~ 50 mAまで、広範囲な測定信号レベルの設定が可能です。(周波数、測定モードにより測定信号レベルの設定範囲は異なります。)

● 基本精度 $\pm 0.05\%$

Zの基本精度は $\pm 0.05\%$ です。部品検査から研究開発の測定まで、お薦めできる精度を持っています。

● 測定ケーブルは4 mまで精度保証

4端子対構造で測定ケーブルの影響を低減し、測定ケーブル長4 mまで精度保証します。自動機の配線が容易になります。IM3523, IM3523A, IM3533はケーブル長補正1 mの設定で、4 mまで精度保証します。(ケーブル長により、精度保証する周波数範囲は異なります。)

● 15種類のパラメータ測定

Z, Y, θ , Rs(ESR), Rp, Rdc(直流抵抗)、X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, D(tan δ), Qのパラメータを測定でき、必要なパラメータをパソコンに取り込むことができます。

● 測定時間 最速2 ms

測定周波数1 kHz, 測定スピードFASTにて、最速2 msで測定が可能です。自動機での使用で検査数量の向上に寄与します。

生産ラインのLCR測定に対応した 機能・特長


IM3523, IM3523A

IM3533

IM3533-01

● コンタクトチェック機能搭載

4端子測定のコンタクトチェック機能と、2端子測定時のHigh-Zリジェクト機能によって、被測定物に測定用電極が接触していない状態で測定することを防ぎます。

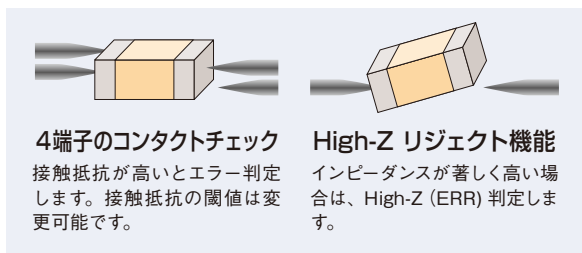

4端子のコンタクトチェック
接触抵抗が高いとエラー判定します。接触抵抗の閾値は変更可能です。


High-Z リジェクト機能
インピーダンスが著しく高い場合は、High-Z (ERR) 判定します。

● 充電されたコンデンサに対する保護*

誤って充電されたコンデンサを測定端子に接続した場合、従来器(3522-50)に比べて10倍の残留電荷量まで保護機能*が向上しました。

*本機能は充電されたコンデンサを測定することを保証したものではありません。必ず放電してから測定してください。

LCRメータを保護できる静電容量と残留電圧の関係

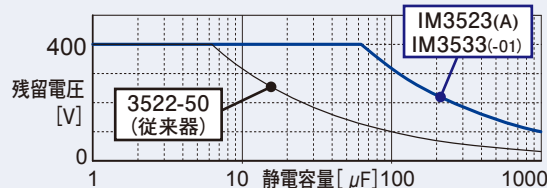

● 異なる測定条件の連続測定

異なる測定項目を異なる測定条件(周波数、レベル、モード)で連続測定することができます。

ここに注目!! ポイント1

測定スピード	IM3523(A), IM3533(-01)の測定時間	3522-50の測定時間
SLOW2	739 ms	824 ms
SLOW	74.2 ms	552 ms
MED	46.2 ms	348 ms
FAST	35.6 ms	328 ms

IM3523(A)、IM3533(-01)と3522-50の連続測定時間の比較

コンデンサのC-DとESR測定など、測定条件が変わる測定を連続して行う場合、当社従来製品(3522-50)に比べて、全体の測定スピードが大きく向上しました。それぞれの測定時間の短縮のほか、レンジの変更や周波数レンジの変更に要する時間を大幅に短縮しています。


LCRメータ IM3523, IM3523A の特長

生産ライン・自動機組み込み



● シンプルで見やすい、モノクロLCD画面、 テンキー操作で簡単設定 **IM3523, IM3523A**

高コントラストグラフィックLCD表示、ファンクションキー・テンキーによる分かりやすいユーザーインターフェイス。コンパレータの設定など数値の設定は、テンキーから簡単かつスピーディーな入力ができます。

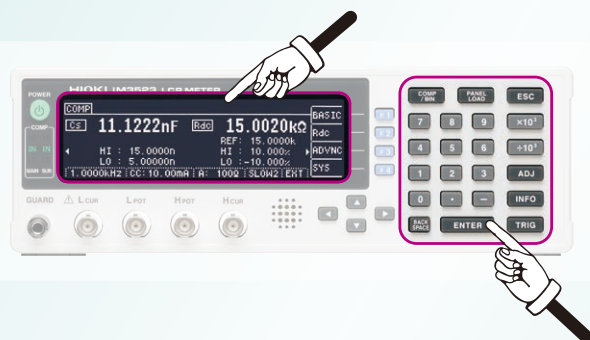

● IM3523, IM3523Aの概要

基本測定項目	Z, Y, θ , Rs, Rp, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, Q, D
測定項目	Rdc ○
トランス測定	-
温度 T	-
基本確度	$\pm 0.05\%rdg.$
測定周波数	40 Hz ~ 200 kHz
測定電圧	5 mV ~ 5 V
測定時間	2 ms
コンパレータ	2項目について: HI/IN/LO, ABS/%/ Δ %
BIN測定	メイン項目: 10分類 / サブ項目: 1分類
ケーブル長	0 m / 1 m
コンタクトチェック	4端子チェック (閾値変更) / Hi Zリジェクト
内部 DC バイアス	-
スイープ測定	-
ディスプレイ	モノクロ LCD
EXT I/O, USB	○
インターフェイス	USB メモリ -
RS-232C, GP-IB, LAN #1	IM3523 でオプション (1種類選択) *1 IM3523A は LAN のみ標準

● 生産ライン・自動機組み込みに最適な 小型サイズ **IM3523, IM3523A**

ベンチ形小型計測器と同じサイズで従来器に比べて小さく、自動機やライン工程内で設置場所の確保が容易です。

● コンパレータ **IM3523, IM3523A**

LCRモードで、測定項目から2種類のHI/IN/LOの判定が可能です。判定方法は絶対値設定の他に、%設定、 Δ %設定が可能です。連続測定を使用すると、複数の測定条件・測定項目にわたる判定ができます。

● BIN測定 **IM3523, IM3523A**

メイン項目について10分類と範囲外、サブ項目について1分類と範囲外への分類ができます。

生産ラインの測定・検査に適した 機能・特長

IM3523, IM3523A **IM3533** **IM3533-01**

● オートレンジの移動範囲の制限機能

測定対象が複数のレンジにまたがる場合に、オートレンジの移動範囲を制限して、測定することができます。オートレンジの広い測定範囲と、設定したレンジ範囲だけのサーチで完了する測定時間の短縮の両方の長所を活かした測定が可能です。

● 2つの連続測定の個々の項目をEXT I/Oから出力

2種類の連続測定の判定項目について、それぞれの判定結果をEXT I/Oから取得することができます。より細かい検査や選別が可能になります。

測定前の準備作業を短縮する 機能・特長

IM3523, IM3523A **IM3533** **IM3533-01**

● リミット値に連動したレンジ設定と、 レンジに連動した設定機能

設定した基準値または範囲に応じて、最適なレンジを自動的に設定します。また、レンジの変更に合わせて測定条件が最適となるように、測定条件を自動的に設定できます。これにより段取り時間の短縮を図ることができます。

● OPEN/SHORT 補正のエリア設定機能

測定周波数範囲が限られている場合は、実際に測定する周波数範囲に限定して、OPEN/SHORT補正を実行することが可能です。全周波数範囲を補正する場合に比べてOPEN/SHORT補正に要する時間を短縮できます。

LCRメータ IM3533 の特長

巻線・コイル・トランス生産



トランス測定

IM3533 IM3533-01

トランス測定専用の画面で巻数比N、相互インダクタンスM、インダクタンス差 ΔL の測定が可能です。

温度補正機能付き Rdc 測定*2

IM3533 IM3533-01

インダクタやトランスの巻線の Rdc 測定では、温度補正付きの状態での測定が可能です。

*2 温度補正した Rdc 測定には、温度プローブ 9478 (オプション) が必要です。

4パラメータ同時表示(通常測定時)

IM3533 IM3533-01

通常測定では4パラメータの同時表示が可能です。パラメータ相互の確認を容易にします。

IM3533の概要

基本測定項目	Z, Y, θ , Rs, Rp, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, Q, D	
測定項目	Rdc	○ (温度補正機能付)
	トランス測定	N, M, ΔL
温度 T	○	
基本精度	$\pm 0.05\% \text{rdg.}$	
測定周波数	1 mHz ~ 200 kHz	
測定電圧	5 mV ~ 5 V / 2.5 V*1	
測定時間	2 ms	
コンパレータ	2項目について: HI/IN/LO, ABS/%/ Δ %	
BIN 測定	2項目について: 10分類	
ケーブル長	0 m / 1 m	
コンタクトチェック	4端子チェック (閾値変更) / Hi Zリジェクト	
内部 DC バイアス	-5 V ~ 5 V	
スweep測定	-	
ディスプレイ	カラー TFT 5.7 inch, タッチパネル	
EXT I/O, USB	○	
インターフェイス	USB メモリ ○	
	RS-232C, GP-IB, LAN	オプション (1種類選択)

*1 2.5 V は低インピーダンス高精度モード時

内部 DC バイアス -5 V ~ 5 V

本体のみで最大 ± 5 V の DC バイアスを印加して測定できます。タンタルコンデンサなど有極コンデンサの測定が安心して行えます。

IM3533 IM3533-01

BIN 測定: 2項目について10分類

2項目について10分類と範囲外への分類ができます。複合部品の選別や、より高度な選別作業に威力を発揮します。


IM3533 IM3533-01

LCR測定の操作を簡単にする 機能・特長

IM3533 IM3533-01

本体モードインジケータ

LCD表示がOFFの場合でも、本体の動作状態がわかります。

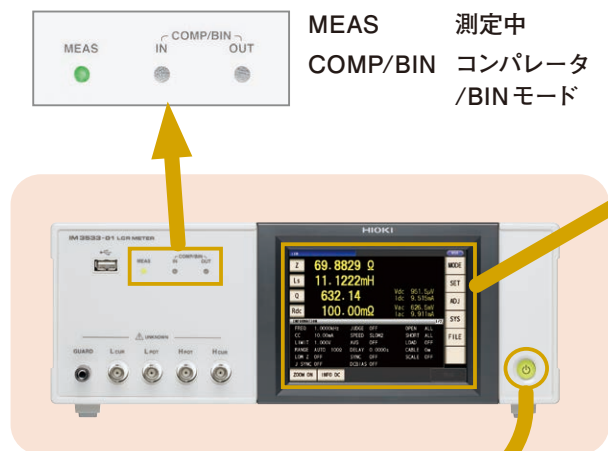

MEAS 測定中
COMP/BIN コンパレータ/BINモード

タッチパネルで分かりやすい操作

従来製品に引き続き、分かりやすい操作のタッチパネル式ディスプレイを採用しました。さらに、カラー液晶搭載で見やすい表示と直感的にわかる抜群の操作性で、お客様の作業効率をアップします。



測定画面 (LCRモード)




測定パラメータ入力画面



基本的な測定条件の設定項目

測定周波数、測定信号レベルなどの測定条件は測定値をモニタしながら変更できます。

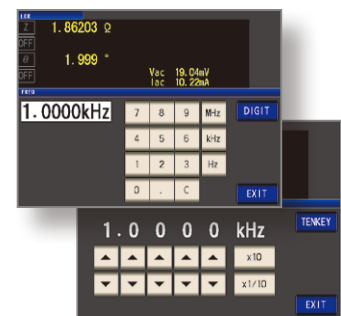

周波数の設定 (10キー入力とアップダウン入力)

電源インジケータ

自動機に組み込まれた場合や、LCD表示がOFFの場合でも、電源投入状況が一目でわかります。

- ・電源 ON 緑
- ・スタンバイ 赤

LCRメータ IM3533-01 の特長 研究開発・電気化学



● 周波数スイープ

IM3533-01

IM3533-01は周波数スイープ測定が可能です。指定した周波数範囲または周波数リストにより、最大801点の周波数での自動測定が可能です。測定結果はUSBメモリやインターフェイスを介してパソコン等に保存でき、試料の周波数解析を補助します。

FREQ[Hz]	Z[Ω]	θ[°]
605.83	20.4452k	-88.680
622.09	19.9123k	-88.673
638.79	19.3944k	-88.664
655.94	18.8889k	-88.663
673.55	18.3956k	-88.644
691.63	17.9173k	-88.634
710.20	17.4492k	-88.619
729.27	16.9939k	-88.606
748.84	16.5517k	-88.588
768.95	16.1239k	-88.574
789.59	15.7055k	-88.570
810.79	15.2958k	-88.564

周波数スイープ測定画面

● IM3533-01の概要

基本測定項目	Z, Y, θ , Rs, Rp, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, Q, D
測定項目	Rdc ○ (温度補正機能付)
トランス測定	N, M, Δ L
温度 T	○
基本精度	$\pm 0.05\%$ rdg.
測定周波数	1 mHz ~ 200 kHz
測定電圧	5 mV ~ 5 V / 2.5 V *1
測定時間	2 ms
コンパレータ	2項目について: HI/IN/LO, ABS/%/ Δ %
BIN 測定	2項目について: 10 分類
ケーブル長	0 m / 1 m / 2 m / 4 m
コンタクトチェック	4端子チェック (閾値変更) / Hi Zリジェクト
内部 DC バイアス	-5 V ~ 5 V
スイープ測定	周波数 2 ~ 801 点
ディスプレイ	カラー TFT 5.7 inch, タッチパネル
EXT I/O, USB	○
インターフェイス	USB メモリ ○
RS-232C, GP-IB, LAN	オプション (1種類選択)

*1 2.5 V は低インピーダンス高精度モード時

● ケーブル長 0 m / 1 m / 2 m / 4 m 設定 & 保証

IM3533-01

ケーブル長設定はシリーズ共通の0 m / 1 mに加え、IM3533-01では2 m / 4 mの設定が可能になります。研究室や自動機で測定ケーブルの延長が必要になった場合でも、最高の性能維持と精度保証を可能にします。延長ケーブルの製作については、必ず取扱説明書をご参照ください。

研究・開発のLCR測定に対応した 機能・特長

IM3533

IM3533-01

● 低周波数 1 mHz から測定可能

低周波数1 mHzから1 mHz分解能*2で測定が可能です。電気化学用途の基本的な測定に使用できます。

*2 100 Hz 以上では有効数字5桁の分解能になります。

● 低インピーダンス高精度モード

100 m Ω と1 Ω レンジで、低インピーダンス高精度モードが使用できます。出力抵抗を25 Ω にすることで測定電流を大きくしますので、測定精度が向上します。(最大印加電流100 mA、最大印加電圧2.5 Vになります。)

電源用の低インダクタンスのインダクタのL測定やアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的です。


ここに注目!! ポイント2

低インピーダンス高精度モードでばらつき改善

IM3533とIM3533-01は、低インピーダンス高精度モードにより、低インピーダンス測定時で、ばらつきの少ない測定が可能になります。

3522-50 (従来器) に比べて高速測定 (FAST, MED) 時に、C-D, ESR 連続測定時の測定スピードが1桁向上すると同時に、Rsのばらつき (繰り返し精度) も改善されています。

C-DとESR測定 (100 kHz) の連続測定時の
連続測定時間とRsの繰り返し精度
(サンプル: アルミ電解コンデンサ 1.5 μ F)

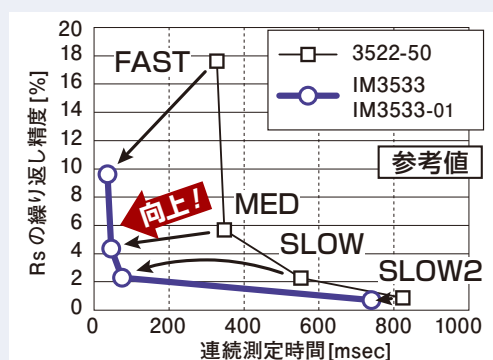

コンデンサ・インダクタ

コンデンサのC-DとESR測定

IM3523, IM3523A

IM3533

IM3533-01



LCRモード [IM3523(A)]
Cs,D表示画面(120 Hz測定)



LCRモード [IM3523(A)]
Rs表示画面(100 kHz測定)



連続測定画面 [IM3523(A)]

高速で、 複数条件の連続測定を実現!

機能性高分子コンデンサではC-D(120 Hz)と低ESR(100 kHz)の測定ができます。異なる測定項目を異なる測定条件(周波数、レベル、モード)で連続測定することができます。


有極性コンデンサのC測定

IM3533

IM3533-01



LCRモード
DCバイアス設定時



バイアス設定部分の拡大

電解コンデンサなど有極性コンデンサでは、DCバイアス電圧を印加して測定する場合があります。

IM3533(-01)は本器のみでDCバイアス(-5 V ~ 5 V)を印加したC-D測定ができます。

インダクタ(コイル・トランス)のRdcとL-Q測定


IM3523, IM3523A

IM3533


IM3533-01



L,Q表示画面(1 kHz,CC1 mA測定)



Rdc表示画面(DC測定)




L, Q, Rdc 連続測定画面
L, Q (1 kHz,CC1 mA測定)と
Rdc (DC測定)の表示画面

L-Q(1 kHz, CC 1 mA)とRdcの連続測定ができます。それぞれの測定結果を同一画面上に表示できます。


コア入りコイルなど、印加電流によりインダクタンス値が変わる「電流依存性」がある素子に対して定電流CCで測定が可能です。

IM3533(-01)では、従来製品に比べて、低インピーダンス測定時の繰り返し精度が向上していますので、Rdcの安定した測定ができます。

ここに注目!! ポイント3



Rdc 温度補正
設定画面



温度補正設定
(拡大)

温度補正した Rdc 測定*

IM3533(-01)では温度補正したRdc測定ができ、より正確な巻線抵抗の管理ができます。

低インピーダンス高精度モードでLが小さいインダクタや、Rdcが小さいインダクタ測定においても、従来器に比べて高精度な測定ができます。

* 温度補正したRdc測定には、温度プローブ9478(オプション)が必要です。


トランス・巻線、スイープ測定

充実したトランス・巻線の測定

IM3533 IM3533-01

L-Q 測定、Rdc 測定に加えて IM3533、IM3533-01 では、トランス測定に必要な巻数比 N、相互インダクタンス M、インダクタンス差 ΔL の測定ができます。*

* 接続は手動で切り換えるか、スキャナなどの切換器を別途ご用意ください。


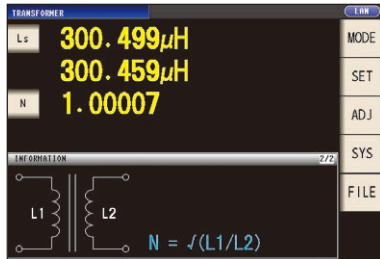


トランス測定モード
巻数比測定(インフォメーション)画面

N 巻数比 N 測定

- (1) 1次側の L (L_1) を測定
- (2) 2次側の L (L_2) を測定
- (3) L_1 と L_2 から巻数比 N を計算

$$N = \sqrt{L_1/L_2}$$





トランス測定モード
巻数比測定・判定画面

M 相互インダクタンス M 測定

- (1) 同相直列接続で L (L_a) を測定
- (2) 逆相直列接続で L (L_b) を測定
- (3) L_a と L_b から M を計算

$$M = (L_a - L_b)/4$$



トランス測定モード
相互インダクタンス測定画面

ΔL インダクタンス差 ΔL 測定

- (1) 1次側の L (L_1) を測定
- (2) 2次側の L (L_2) を測定
- (3) L_1 と L_2 から差 ΔL を計算

$$\Delta L = L_1 - L_2$$



トランス測定モード
インダクタンス差測定画面

スイープ測定

IM3533-01

IM3533-01 は周波数のスイープ測定ができます。L、C、複合部品など各種試料の周波数特性の測定が可能であり、研究・開発に役立ちます。

付属の LCR サンプルアプリケーションを使用して、パソコン上で周波数特性リストとグラフを表示できます。




IM3533-01
スイープ測定



USB メモリ

USB 接続

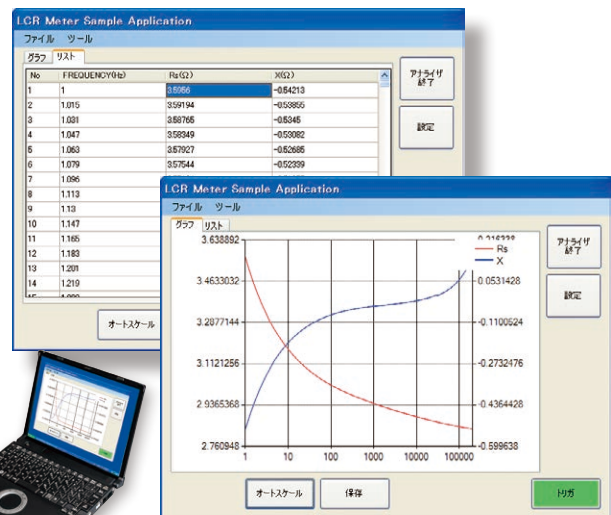


LCR サンプルアプリケーションで表示した
スイープ測定結果のリストとグラフ画面

パソコンとリンク 測定データの取得

● フロント USB で保存と読み込み IM3533 IM3533-01


測定結果や設定は、フロントパネルに接続した市販のUSBメモリに保存できます。

(フロントパネルのUSB端子は、USBメモリ接続専用です。測定結果はIM3533(-01)の内部メモリに保存した後、USBメモリにまとめて保存します。相性により使用できないUSBメモリが存在します。)

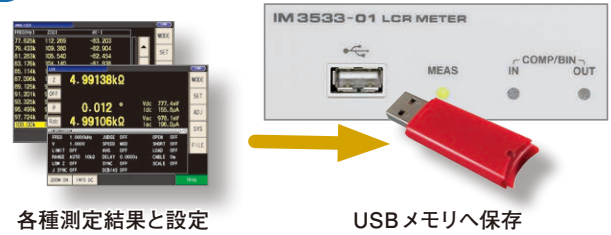


各種測定結果と設定

USBメモリへ保存

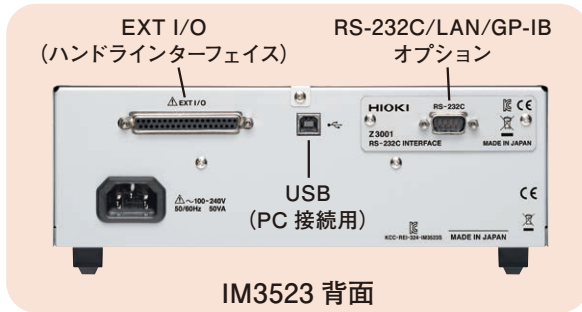

IM3523 背面

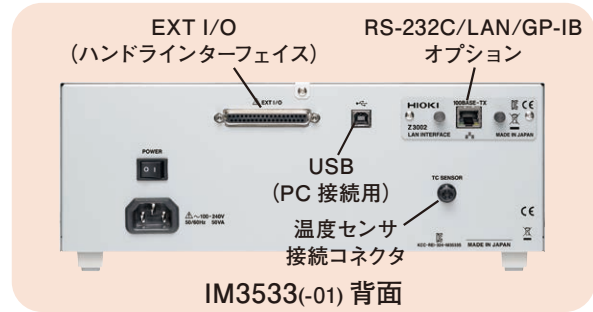

IM3533(-01) 背面

● USBでPCと接続 IM3523, IM3523A IM3533 IM3533-01

リアパネルにUSBを標準装備しています。
(リアパネルのUSB端子は、PC接続専用です。)

IM3523(A), IM3533(-01)の各種機能をパソコンからコントロールができ、測定結果の取得が可能です。
(電源ON/OFFとインターフェイス設定の一部を除きます。)



USB
接続

PC

● RS-232C, LAN, GP-IB (選択オプション) で、PCやPLCと接続 IM3523 IM3533 IM3533-01

RS-232C, LAN, GP-IB インターフェイスが必要である場合は、
どれか1つをオプションで選択できます。
IM3523, IM3533(-01)の各種機能をPLCまたはパソコンからコントロールができ、測定結果の取得が可能です。(電源ON/OFFとインターフェイス設定の一部を除きます。)

RS-232Cケーブルは、下図の結線方法のケーブルをご使用ください。
インタリンク対応のクロスケーブルが使用できます。

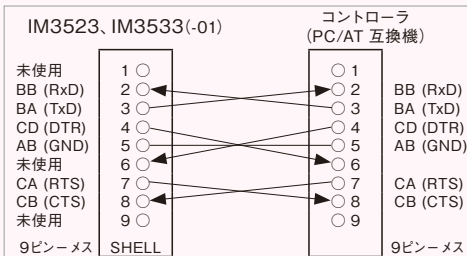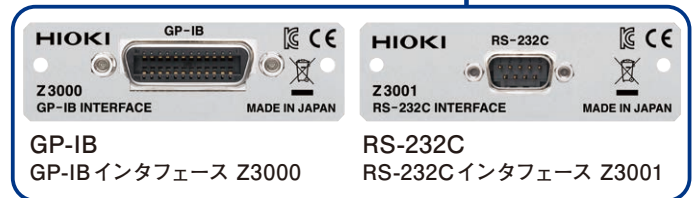
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
LAN インタフェース Z3002GP-IB
GP-IB インタフェース Z3000RS-232C
RS-232C インタフェース Z3001

● IM3523A は LAN インターフェイス標準搭載 IM3523A

IM3523A はリアパネルに LAN (100BASE-T) を標準で搭載しています。

その他の仕様は IM3523 と同じです。

(IM3523A はオプションの GP-IB, RS-232C の選択はできません。)

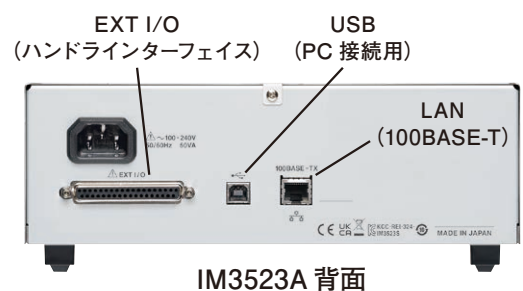

IM3523A 背面


EXT I/O

●ハンドラ (EXT I/O) インターフェイス

ハンドラインターフェイス (EXT I/O) は、測定終了信号や判定結果信号を出力したり、測定トリガ信号などを入力して測定器の制御を行うことができます。各信号線は計測回路・制御回路から絶縁し、ノイズに強い構造になっています。

EXT I/O を使用した制御システムを設計する場合は、必ず取扱説明書をお読み頂き、必要な技術情報をご確認ください。

■代表的な EXT I/O タイミングの例 (LCR モード)

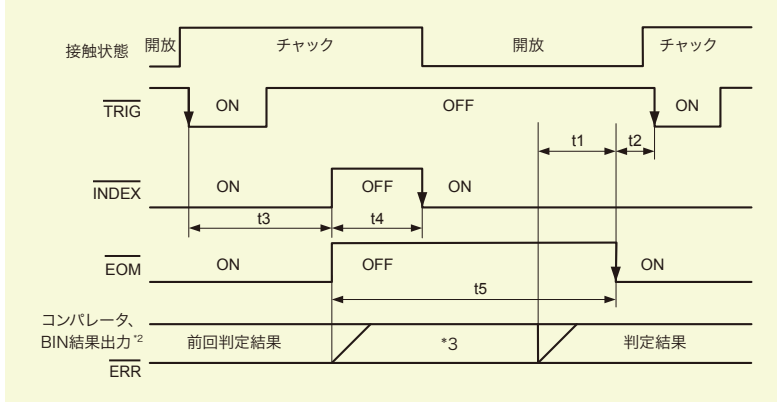

- t1: コンパレータ、BIN 判定結果から \overline{EOM} (LOW) まで、デレイ設定時間; 40 μ s 以上^{*1}
- t2: 測定終了から次のトリガまでの最小時間; 400 μ s^{*1}
- t3: トリガから回路が応答するまでの時間; 700 μ s^{*1}
- t4: 最小チャック時間、 \overline{INDEX} (LOW) でチャック切替可能; 220 μ s^{*1}
- t5: 測定時間; 600 μ s^{*1}

- *1: 測定スピード: FAST、レンジ: HOLD の場合。
- *2: IM3523 (A): MAIN-HI, MAIN-IN, MAIN-LO, SUB-HI, SUB-IN, SUB-LO, AND, BINx, OUT-OF-BINS, SUBNG
IM3533 (-01): PARAx-HI, PARAx-IN, PARAx-LO, AND, BINx, OUT_OF_BINS
- *3: TRIG と同時にリセットする: HIGH
TRIG と同時にリセットしない: LOW

■測定スピード (1 kHz、画面非表示の場合^{*4})

FAST	MED	SLOW	SLOW2
約 2 ms	約 6 ms	約 21 ms	約 301 ms

- *4: 下記の場合は該当する時間をすべて加算します。
- ・OPEN/SHORT/LOAD 補正ありの場合: max 0.4 ms
- ・コンパレータ測定時: max 0.4 ms
- ・BIN 測定時: max 0.8 ms
- ・画面表示 ON 時: max 0.3 ms
- ・メモリ機能 ON 時: max 0.4 ms

■EXT I/O 信号一覧

●入力信号		
TRIG	外部トリガ	
$\overline{LD0} \sim \overline{LD6}$	パネルナンバ選択	
LD_VALID	パネルロード実行	
●出力信号		
EOM	測定終了	
INDEX	取り込み終了	
ERR	測定異常出力	
ISO_5 V	内部絶縁 5 V	
ISO_COM	内部絶縁コモン	
●出力信号 (共用の信号線)		
IM3523, IM3523A	IM3533, IM3533-01	
MAIN-HI, MAIN-IN, MAIN-LO, SUB-HI, SUB-IN, SUB-LO, AND, SUBNG	PARAx-HI, PARAx-IN, PARAx-LO (x=1,3), AND	コンパレータの判定結果出力
BINx (x=1~10), \overline{OUT}	\overline{BINx} (x=1~10), $\overline{OUT_OF_BINS}$	BIN 判定結果出力
No.n_x-HI, No.n_x-IN, No.n_x-LO (n=1,2; x=MAIN, SUB)	No.n_PARAx-HI, No.n_PARAx-IN, No.n_PARAx-LO (n=1,2; x=1,3)	連続測定結果出力
—————	HI, IN, LO, AND	トランスモード



■EXT I/O 電氣的仕様

- 入力:
 - フォトカプラ絶縁 無電圧接点入力 (電流シンク出力対応、負論理)
 - H (有効): 0 ~ 1 V (入力電流 3 mA)
 - L (無効): オープン または 5 ~ 30 V
- 出力:
 - フォトカプラ絶縁 NPN オープンコレクタ (電流シンク出力対応、負論理)
 - DC30 V, DC50 mA max/ch
 - 残留電圧 1.5 V 以下 (50 mA)、1 V 以下 (10 mA)
- サービス電源出力 (内部電源):
 - DC 4.5 ~ 5 V, DC 100 mA max、外部電源入力なし、保護接地および測定回路から絶縁

■コネクタ

使用コネクタ (本体側)	D-SUB 37 ピン メス #4-40 インチネジ
適合コネクタ	DC-37P-ULR (半田型)、DCSP-JB37PR (圧接型) 日本航空電子工業社製

■EXT I/O の入出力回路

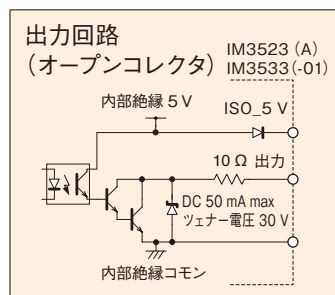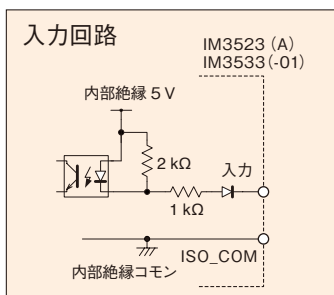

IM3523, IM3523A, IM3533, IM3533-01 測定精度 (精度保証期間 1年)

●条件 温湿度範囲 23°C±5°C、80% rh 以下 (結露なきこと)、電源投入後 60 分以上経って、オープン、ショート補正実行後

●測定精度 測定精度は以下の式から計算
測定精度 = 基本精度 × C × D × E × F × G

【C：レベル係数】 V：設定値 (Vモード時相当) [V]

直流抵抗測定	AC 測定
2 V: 1	0.005 V ~ 0.999 V: 1+0.2/V 1 V: 1 1.001 V ~ 5 V: 1+2/V

【D：測定スピード係数】

直流抵抗測定	AC 測定
FAST: 4	FAST: 8
MED: 3	MED: 4
SLOW: 2	SLOW: 2
SLOW2: 1	SLOW2: 1

【F：DCバイアス係数】

DC バイアス設定 OFF: 1
DC バイアス設定 ON: 2

【E：測定ケーブル長係数】 f_m：測定周波数 [kHz]

ケーブル長	IM3523, IM3523A, IM3533		IM3533-01
	10 kΩレンジ以下	100 kΩレンジ以上	
0 m	1	1	1
1 m	1.2	1.2	1.2
2 m	1.5 + f _m /100	1.5 + f _m /20	1.5
4 m	2 + f _m /50	2 + f _m /10	2

特性インピーダンス 50 Ω の同軸ケーブル (1.5D-2 V) を 4 端子対構造でご使用ください。

精度保証範囲 (周波数)

ケーブル長	IM3523, IM3523A, IM3533		IM3533-01
	10 kΩレンジ以下	100 kΩレンジ以上	
0 m	200 kHz まで	200 kHz まで	200 kHz まで (制限なし)
1 m		100 kHz まで	
2 m		10 kHz まで	
4 m		10 kHz まで	

【G：温度係数】 t：使用温度

t が 18°C ~ 28°C の場合: 1
t が 0°C ~ 18°C 未満, 28°C を越え ~ 40°C の場合: 1 + 0.1 × |t - 23|

●基本精度(Z, θ)計算式

基本精度は、基本精度表より係数 A、B を選択し、下記の計算式から算出します。

$$\text{精度} = A + B \times \left| \frac{10 \times Z_x}{\text{レンジ}} - 1 \right|$$

$$\text{精度} = A + B \times \left| \frac{\text{レンジ}}{Z_x} - 1 \right|$$

1 kΩレンジ以上と 100 Ωレンジ以下では、基本精度の計算式が左に示すように異なります。13 ページの計算例を参照してください。

Z_x は試料のインピーダンス実測値 (Z)

Rdc 測定時の温度補正時は、基本精度計算式に次の値を加算します。

$$\frac{-100 \alpha_{t_0} \Delta t}{1 + \alpha_{t_0} \times (t + \Delta t - t_0)} \quad [\%]$$

t₀: 基準温度 [°C]
t: 現在の周囲温度 [°C]
Δt: 温度測定精度
α_{t₀}: t₀ の時の温度係数 [1/°C]

●基本精度表

係数 A、B について

DC 時
A: R の精度 (±% rdg.)
B: 試料の抵抗に関する係数

0.001 Hz (40 Hz) ~ 200 kHz 時
上側 A: Z の基本精度 (±% rdg.)
B: 試料のインピーダンスに関する係数

0.001 Hz (40 Hz) ~ 200 kHz 時
下側 A: θ の基本精度 (± deg.)
B: 試料のインピーダンスに関する係数

レンジ	精度保証範囲	DC	IM3523, IM3523A 40.000 Hz ~ 99.999 Hz IM3533, IM3533-01 0.001 Hz ~ 99.999 Hz	100.00 Hz ~ 999.99 Hz	1.0000 kHz ~ 10.000 kHz	10.001 kHz ~ 100.00 kHz	100.01 kHz ~ 200.00 kHz
100 MΩ	8 MΩ ~ 200 MΩ	A=1 B=1	A=6 B=5 A=5 B=3	A=3 B=2 A=2 B=2	A=3 B=2 A=2 B=2		
10 MΩ	800 kΩ ~ 100 MΩ	A=0.5 B=0.3	A=0.8 B=1 A=0.8 B=0.5	A=0.5 B=0.3 A=0.4 B=0.2	A=0.5 B=0.3 A=0.4 B=0.2	A=3 B=2 A=2 B=2	
1 MΩ	80 kΩ ~ 10 MΩ	A=0.2 B=0.1	A=0.4 B=0.08 A=0.3 B=0.08	A=0.3 B=0.05 A=0.2 B=0.02	A=0.3 B=0.05 A=0.2 B=0.02	A=0.7 B=0.08 A=1.3 B=0.08	A=1 B=0.5 A=3 B=0.5
100 kΩ	8 kΩ ~ 1 MΩ	A=0.1 B=0.01	A=0.3 B=0.03 A=0.3 B=0.02	A=0.2 B=0.03 A=0.1 B=0.02	A=0.15 B=0.02 A=0.1 B=0.015	A=0.25 B=0.04 A=0.4 B=0.02	A=0.4 B=0.3 A=1.2 B=0.3
10 kΩ	800 Ω ~ 100 kΩ	A=0.1 B=0.01	A=0.3 B=0.025 A=0.3 B=0.02	A=0.2 B=0.025 A=0.1 B=0.02	A=0.05 B=0.02 A=0.03 B=0.02	A=0.2 B=0.025 A=0.4 B=0.02	A=0.3 B=0.03 A=0.6 B=0.05
1 kΩ	80 Ω ~ 10 kΩ	A=0.1 B=0.01	A=0.3 B=0.02 A=0.2 B=0.02	A=0.2 B=0.02 A=0.1 B=0.02	A=0.15 B=0.02 A=0.08 B=0.02	A=0.2 B=0.02 A=0.4 B=0.02	A=0.3 B=0.02 A=0.6 B=0.02
100 Ω	8 Ω ~ 100 Ω	A=0.1 B=0.02	A=0.4 B=0.02 A=0.2 B=0.01	A=0.3 B=0.02 A=0.15 B=0.01	A=0.15 B=0.02 A=0.1 B=0.01	A=0.2 B=0.02 A=0.4 B=0.02	A=0.3 B=0.03 A=0.6 B=0.02
10 Ω	800 mΩ ~ 10 Ω	A=0.2 B=0.15	A=0.5 B=0.2 A=0.3 B=0.1	A=0.4 B=0.05 A=0.3 B=0.03	A=0.3 B=0.05 A=0.15 B=0.03	A=0.3 B=0.05 A=0.75 B=0.05	A=0.4 B=0.2 A=1.5 B=0.1
1 Ω	80 mΩ ~ 1 Ω	A=0.3 B=0.3	A=2 B=1 A=1 B=0.6	A=0.6 B=0.3 A=0.5 B=0.2	A=0.4 B=0.3 A=0.25 B=0.2	A=0.4 B=0.3 A=1 B=0.2	A=1 B=1 A=2 B=0.5
100 mΩ	10 mΩ ~ 100 mΩ	A=3 B=3	A=10 B=10 A=6 B=6	A=3 B=3 A=2 B=2	A=3 B=2 A=2 B=1.5	A=2 B=2 A=2 B=1.5	A=4 B=3 A=3 B=4

測定精度

● 精度保証範囲 (測定信号レベル)

測定周波数、測定信号レベル、測定レンジにより精度保証範囲が異なります。

レンジ	DC	IM3523, IM3523A	40.000 Hz ~ 99.999 Hz	100.00 Hz ~ 999.99 Hz	1.0000 kHz ~ 10.000 kHz	10.001 kHz ~ 100.00 kHz	100.01 kHz ~ 200.00 kHz	
		IM3533	IM3533-01	0.001 Hz ~ 99.999 Hz				
100 MΩ	2 V	0.101 V ~ 5 V						
10 MΩ						0.501 V ~ 5 V		
1 MΩ		0.050 V ~ 5 V			0.101 V ~ 5 V			
100 kΩ		0.005 V ~ 5 V					0.050 V ~ 5 V	0.101 V ~ 5 V
10 kΩ, 1 kΩ, 100 Ω		0.050 V ~ 5 V						
10 Ω		0.101 V ~ 5 V (DC バイアス時: 1 V ~ 5 V)						
1 Ω								
100 mΩ		0.501 V ~ 5 V (DC バイアス時: 0.501 V ~ 5 V)						

上記電圧は、V モード時相当の電圧設定値。

10 MΩ ~ 1 kΩ レンジでは、測定値 (インピーダンス値) がレンジを越える場合、精度保証範囲が下記の通りになります。

レンジ	DC	IM3523, IM3523A	40.000 Hz ~ 99.999 Hz	100.00 Hz ~ 999.99 Hz	1.0000 kHz ~ 10.000 kHz	10.001 kHz ~ 100.00 kHz	100.01 kHz ~ 200.00 kHz	
		IM3533	IM3533-01	0.001 Hz ~ 99.999 Hz				
10 MΩ	2 V	0.101 V ~ 5 V						
1 MΩ						0.501 V ~ 5 V		
100 kΩ		0.050 V ~ 5 V			0.101 V ~ 5 V			
10 kΩ		0.005 V ~ 5 V					0.005 V ~ 5 V	0.101 V ~ 5 V
1 kΩ								

上記電圧は、V モード時相当の電圧設定値。

● 基本精度の求め方

- 基本精度は、試料のインピーダンス、測定レンジ、測定周波数、および 12 ページの表から該当する基本精度 A と係数 B を選び計算します。
- 計算式は、1 kΩ レンジ以上と、100 Ω レンジ以下では、それぞれ別の計算式を使用します。
- C、L は、インピーダンスの実測値か、次の式で計算されるおおよそのインピーダンス値から測定レンジを決め、基本精度 A、係数 B を求めます。

$$Z_x (\Omega) \div \omega L (H) \quad (\theta \div 90^\circ)$$

$$\div \frac{1}{\omega C (F)} \quad (\theta \div -90^\circ)$$

$$\div R (\Omega) \quad (\theta \div 0^\circ) \quad (\omega : 2 \times \pi \times \text{測定周波数} [Hz])$$

● 計算例 1 (インピーダンス Z の基本精度)

試料のインピーダンス Z_x : 500 Ω (実測値)
測定条件 : 周波数 10 kHz、レンジ 1 kΩ の場合

● 計算例 2 (コンデンサ $C_s = 160$ nF の基本精度)

測定条件 : 周波数 1 kHz の場合

(1) 試料の Z、 θ を測定します。測定レンジは AUTO で測定します。

(2) 測定した Z、 θ が次の値であったとします。

$$Z = 1.0144 \text{ k}\Omega, \quad \theta = -78.69^\circ$$

Z が 1.0144 kΩ ですので、10 kΩ レンジになります。

(3) 12 ページの表から 1 kHz、10 kΩ レンジでは、Z の基本精度の係数 A=0.05、係数 B=0.02 を式に代入。

$$Z \text{ 基本精度} = \pm \left(0.05 + 0.02 \times \left| \frac{10 \times 1.0144 \times 10^3}{10 \times 10^3} - 1 \right| \right) \div 0.05 (\pm\%)$$

θ の基本精度の係数 A=0.03、係数 B=0.02 を式に代入。

$$\theta \text{ 基本精度} = \pm \left(0.03 + 0.02 \times \left| \frac{10 \times 1.0144 \times 10^3}{10 \times 10^3} - 1 \right| \right) \div 0.03 (\pm^\circ)$$

パソコンで基本精度の計算ができます

付属のアプリケーションソフトで、この基本精度の計算ができます。測定条件と測定結果を入力すると、測定精度が表示されます。測定値の精度評価が簡単に行えます。

HIOKI ホームページ (<http://www.hioki.co.jp/>) のサポートのダウンロードのページからも入手できます。



アプリケーション画面

12 ページの表から、Z の基本精度の係数 A = 0.15、係数 B = 0.02 を式に代入。

$$Z \text{ 基本精度} = 0.15 + 0.02 \times \left| \frac{10 \times 500}{10^3} - 1 \right| = 0.23 (\pm \% \text{rdg.})$$

同様に θ の基本精度の係数 A = 0.08、係数 B = 0.02 から

$$\theta \text{ 基本精度} = 0.08 + 0.02 \times \left| \frac{10 \times 500}{10^3} - 1 \right| = 0.16 (\pm^\circ)$$

(4) 基本精度 Z、 θ の取り得る範囲を求めます。

$$Z_{\min} = 1.0144 \text{ k}\Omega \times (1 - 0.05/100) = 1.01389 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{\max} = 1.0144 \text{ k}\Omega \times (1 + 0.05/100) = 1.01490 \text{ k}\Omega$$

$$\theta_{\min} = -78.69 - 0.03 = -78.72^\circ$$

$$\theta_{\max} = -78.69 + 0.03 = -78.66^\circ$$

(5) Z と θ の範囲から C_s の取り得る範囲を求めます。

$$C_s \text{ min} = 1 / (Z_{\max} \times \omega \times \sin(\theta_{\min})) \div 159.907 \text{ nF} \dots\dots - 0.06\%$$

$$C_s \text{ max} = 1 / (Z_{\min} \times \omega \times \sin(\theta_{\max})) \div 160.100 \text{ nF} \dots\dots + 0.06\%$$










仕様

	IM3523, IM3523A	IM3533	IM3533-01
測定モード	LCRモード：単一条件で測定 連続測定モード： 保存した条件を連続で測定 (最大2通り)	LCRモード：単一条件で測定 トランス測定モード：N,M,ΔL 連続測定モード： 保存した条件を連続で測定 LCRモード(最大60通り)	LCRモード：単一条件で測定 トランス測定モード：N,M,ΔL 連続測定モード： 保存した条件を連続で測定 LCRモード(最大60通り) アナライザモード(最大2通り) アナライザモード：測定周波数でスイープ (測定点：2～801, 掃引方法：通常掃引、 表示：リスト表示)
測定パラメータ	Z, Y, θ , Rs(ESR), Rp, Rdc(直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D(tan δ), Q	Z, Y, θ , Rs(ESR), Rp, Rdc(直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D(tan δ), Q, N, M, ΔL, T	
測定レンジ	100 mΩ ~ 100 MΩ, 10レンジ, (全てのパラメータはZで規定)		
表示範囲	Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ±(0.00000 [単位] ~ 9.99999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示 θ : ±(0.000° ~ 180.000°), D : ±(0.00000 ~ 9.99999), Q : ±(0.00 ~ 9999.99), Δ% : ±(0.000% ~ 999.999%) T : -10.0 ~ +99.9°C		
基本確度	Z : ±0.05% rdg. θ : ±0.03°		
測定周波数	40 Hz ~ 200 kHz (設定分解能 5桁分解能)	1 mHz ~ 200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能 1 mHz)	
測定信号レベル	通常モード： Vモード・CVモード：5 mV ~ 5 V rms, 1 mV rmsステップ CCモード：10 μA ~ 50 mA rms, 10 μA rmsステップ	通常モード： Vモード・CVモード：5 mV ~ 5 V rms, 1 mV rmsステップ CCモード：10 μA ~ 50 mA rms, 10 μA rmsステップ 低インピーダンス高精度モード： Vモード・CVモード：5 mV ~ 2.5 V rms, 1 mV rms ステップ CCモード：10 μA ~ 100 mA rms, 10 μA rmsステップ	
出力インピーダンス	通常モード：100 Ω	通常モード：100 Ω、低インピーダンス高精度モード：25 Ω	
表示	モノクロLCD	カラーTFT 5.7inch、表示 ON/OFF 設定可能	
表示桁数設定	3 ~ 6桁の表示桁数の設定が可能、初期値6桁		
測定時間	2 ms (1 kHz, FAST、ディスプレイOFF、代表値)		
測定スピード	FAST/MED/SLOW/SLOW2		
DCバイアス測定	—	通常モード：-5.00 V ~ 5.00 V (10 mVステップ) 低インピーダンス高精度モード：-2.50 V ~ 2.50 V (10 mVステップ)	
直流抵抗測定	測定信号レベル：2 V固定	測定信号レベル：2 V固定 温度補正機能：基準温度に換算して表示 基準温度設定範囲：-10°C ~ 99.9°C 温度係数設定範囲：-99,999 ppm/°C ~ 99,999 ppm/°C	
コンパレータ	LCRモード：第1、第3項目に対してHI/IN/LO		
B I N 測定	主パラメータ10分類、サブパラメータ1分類、範囲外	2項目について10分類、範囲外	
補正	オープン/ショート/ロード/相関補正 ケーブル長：0.1 m (4 mまで精度保証)	オープン/ショート/ロード/相関補正 ケーブル長：0.1, 2, 4 m	
残留電荷保護機能	$V = \sqrt{10/C}$ (C: 試料の容量[F], V: 最大400 V)		
トリガ同期出力機能	アナログ計測中のみ測定信号を印加		
アベレージ	1 ~ 256		
パネルロード・セーブ	LCRモード：60、アナライザモード：2、補正值：128		
メモリ機能	32,000データを本体のメモリに保存		
インターフェイス	EXT I/O (ハンドラ), USB(Hi-Speed)*1, LAN*2 オプション (IM3523のみ) : RS-232C/GP-IB/LAN (10BASE-T/100BASE-TX)の1種類を装着可能	EXT I/O (ハンドラ), USB (Hi-Speed), USBメモリ オプション：RS-232C/GP-IB/LAN (10BASE-T/100BASE-TX) の1種類を装着可能	
使用温湿度範囲	0 °C ~ 40 °C, 80 % rh以下、結露なきこと		
保存温湿度範囲	-10 °C ~ 50 °C, 80 % rh以下、結露なきこと		
電源	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 50 VA max.		
寸法・質量	約 260W×88H×203D mm, 約2.4 kg (IM3523A:約2.1 kg)	約 330W×119H×168D mm, 約3.1 kg	
付属品	電源コード×1、取扱説明書×1 (IM3523AはCD-Rに収録)、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト)×1		
適合規格	EMC: EN61326-1、安全性: EN61010		

*1 IM3523Aは、USB(Full-Speed)

*2 LAN(100BASE-T)はIM3523Aに標準。RS-232C, GP-IBのオプション選択は不可

■ LCR メータシリーズ セレクション

LCR メータ一覧		測定スピード (代表値)	測定周波数範囲	
			用途／測定対象	
LCR メータ IM3536		1 ms	DC ○ 4 Hz ● 8 MHz ●	8MHzの汎用LCRメータ コンデンサ、インダクタなどの電子部品
LCR メータ IM3533 IM3533-01		2 ms	DC ○ 1 MHz ● 200 kHz ●	巻数比／相互インダクタンス測定などトランス専用測定が可能 IM3533-01は周波数スイープ測定を搭載
LCR メータ IM3523 IM3523A		2 ms	DC ○ 40 Hz ● 200 kHz ●	自動機組み込みなど、生産ラインに適したハイコストパフォーマンス製品 電解コンデンサのC-D/ESR測定、インダクタのL-Q/Rdc測定
LCR ハイテスタ 3511-50		5 ms	120 Hz ○ 1 kHz ○	小型・単機能のLCRメータ アルミ電解コンデンサの生産ライン
C メータ 3506-10		1.5 ms	1 kHz ○ 1 MHz ○	低容量コンデンサ用のCメータ MLCC、フィルムコンデンサの生産
C ハイテスタ 3504-40 3504-50 3504-60		2 ms	120 Hz ○ 1 kHz ○	大容量MLCC用のCメータ 大容量MLCCの選別機(3504-50/-60)、テーピングマシン(3504-40)
インピーダンス アナライザ IM7580A		0.5 ms	1 MHz ● 300 MHz ●	300MHzの高周波測定が可能 フェライトビーズ、インダクタの生産ライン
インピーダンス アナライザ IM3570		0.5 ms	DC ○ 4 Hz ● 5 MHz ●	LCRメータとインピーダンスアナライザを1台で実現 圧電素子の周波数特性、機能性高分子コンデンサ、パワーインダクタ
ケミカル インピーダンス アナライザ IM3590		2 ms	DC ○ 1 MHz ● 200 kHz ●	Cole - Cole プロット、等価回路解析とインピーダンス(LCR)の測定に対応 電気化学部品および材料／電池／EDLC(電気二重層コンデンサ)の測定

本体

IM3523, IM3523A



写真は IM3523A

IM3533, IM3533-01



付属品：電源コード、取扱説明書*1、CD-R(通信取扱説明書、サンプルソフト)
*1 IM3523A は CD-R に収録

製品名：LCR メータ IM3523, IM3523A	
形名(発注コード)	(仕様)
IM3523	—
IM3523A	(LAN インターフェイス標準)
製品名：LCR メータ IM3533	
形名(発注コード)	(仕様)
IM3533	—
IM3533-01	(IM3533 に機能追加)

テストフィクスチャ・プローブは本体には付属されていません。
オプションのテストフィクスチャ・プローブを選択してください。
特性インピーダンス 50Ω の同軸ケーブルを使用しています (P3 参照)。

オプション (IM3523, IM3533, IM3533-01 用)

インターフェイスユニット



GP-IB インタフェース
Z3000



RS-232C インタフェース
Z3001*2



LAN インタフェース
Z3002

*2 RS-232C ケーブルについて
RS-232C ケーブルはインタリンク対応のクロスケーブルが使用できます。
RS-232C ケーブル 9637 (9 ピン-9 ピン、クロスタイプ) は、ハードウェアフロー制御の使用を伴う場合にお使いいただけません。



GP-IB 接続ケーブル 9151-02
2 m

DC バイアスユニット



DC バイアス
電圧ユニット
9268-10
直結型, 40 Hz ~ 8 MHz, 最大印加電圧
DC ±40 V



DC バイアス
電流ユニット
9269-10
直結型, 40 Hz ~ 2 MHz, 最大印加電流
DC 2 A (最大印加電圧 DC ±40 V)
内部インダクタンス 300 μH が試料と並列
に接続されます。

9268-10 または 9269-10 使用の際は、外付けの定電圧源、定電流源が必要になります。

温度プローブ



シース形温度プローブ 9478 (防水構造)
Pt100, 先端φ2.3 mm, コード長 1 m, 防水性: EN60529:1991, IP67



リード部品用 プローブ、テストフィクスチャ



4 端子プローブ
L2000

ケーブル長 1 m, DC ~ 8 MHz,
特性インピーダンス 50 Ω, 4 端子対構造,
測定可能端子直径: 0.3 ~ 5 mm



テストフィクスチャ
9261-10

ケーブル長 1 m, DC ~ 8 MHz,
特性インピーダンス 50 Ω, 4 端子対構造,
測定可能端子直径: 0.3 ~ 1.5 mm



4 端子プローブ
9140-10

ケーブル長 1 m, DC ~ 200 kHz,
特性インピーダンス 50 Ω, 4 端子対構造,
測定可能端子直径: 0.3 ~ 5 mm



テストフィクスチャ
9262

直結型, DC ~ 8 MHz,
測定可能端子直径: 0.3 ~ 2 mm

SMD 用テストフィクスチャ



SMD テストフィクスチャ
IM9110

直結型, 0201 サイズの SMD に対応, 側面に
電極がある SMD 用, 電極 2 端子構造,
DC ~ 1 MHz



SMD テストフィクスチャ
IM9100

0402, 0603, 1005, 3 サイズの SMD に対応, 電
極 4 端子構造, 高精度測定を可能にするテ
ストフィクスチャ



SMD テストフィクスチャ
9677

直結型, 側面に電極がある SMD 用, DC
~ 120 MHz, 試料寸法: 3.5 ± 0.5 mm



ピンセットプローブ
L2001

IM9901 × 1 標準付属
ケーブル長 730 mm, DC ~ 8 MHz, 特性イン
ピーダンス 50 Ω, 4 端子対構造, 電極 2 端子,
先端電極間隔: 0.3 ~ 約 6 mm



SMD テストフィクスチャ
9699

直結型, 底面に電極がある SMD 用,
DC ~ 120 MHz, 試料寸法: 幅 1.0 ~ 4.0
mm, 高さ 1.5 mm 以下



SMD テストフィクスチャ
9263

直結型, DC ~ 8 MHz,
試料寸法: 1 ~ 10 mm

L2001 用 オプション

ピンセット先端交換用部品



コンタクトチップ IM9901
適用チップサイズ: 1608 ~ 5750 (JIS)



コンタクトチップ IM9902
適用チップサイズ: 0603 ~ 5750 (JIS)

電気化学測定用 4 端子プローブ



4 端子プローブ
9500-10

ケーブル長 1 m, DC ~ 200 kHz, 特性イン
ピーダンス 50 Ω, 4 端子対構造, 測定可能
端子直径: 0.3 ~ 2 mm

日置電機株式会社

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉 81

製品に関するお問い合わせはこちら

本社 カスタマーサポート

0120-72-0560

(9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00, 土・日・祝日を除く)

☎ 0268-28-0560 ✉ info@hioki.co.jp

詳しい情報は WEB で検索

お問い合わせは...



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp